

《麻醉安全与质控》杂志图表制作要求

一、图片制作要求 (示例图)

图片尺寸 (半栏不超过 8cm, 全栏不超过 17cm), 图片分辨率 (单色不低于 1200dpi, 彩色不低于 600dpi)

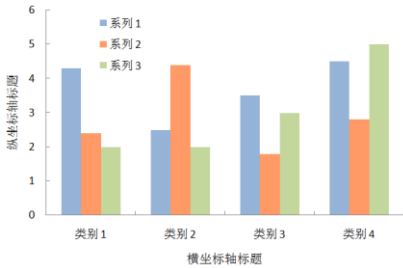


图 1 柱状图示例

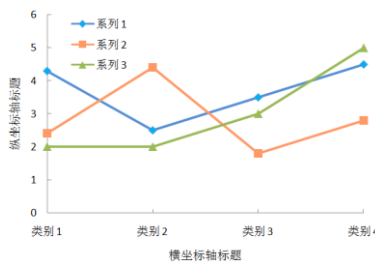


图 2 折线图示例

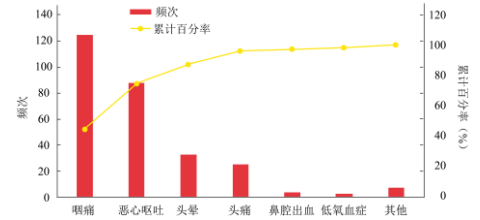


图 3 帕累托图示例

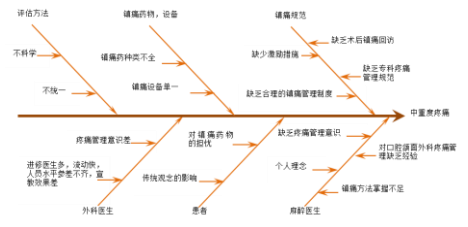
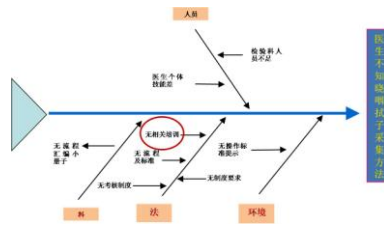
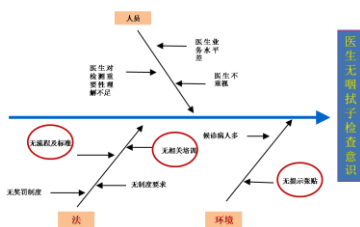


图 4 鱼骨图示例



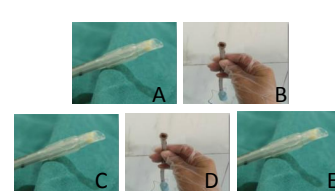
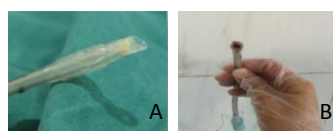


图 5 照片图(单张照片图和多张照片图排列方式)

二、表格制作要求 (示例表格)

表格组成部分: 表序、表题、项目栏、表体、表注。表格尺寸 (半栏不超过 8cm, 全栏不超过 17cm)

表 1 三线表 ($\bar{x} \pm s$)

| 组别 | 平卧位喉镜组 | 平卧位光棒组 | 侧卧位光棒组 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 女/男 (<i>n</i>) | 11/14 | 12/13 | 10/15 |
| 年龄 (岁) | 52.1±12.1 | 54.5±11.9 | 53.4±12.8 |
| 身高 (cm) | 165.2±5.9 | 163.8±6.2 | 164.7±6.7 |
| 体质量(kg) | 63.2±8.13 | 62.8±7.9 | 63.9±7.5 |

表 2 三线子表 ($\bar{x} \pm s$)

| 组别 | MAP (mmHg) | | | HR (次/分) | | |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 平卧位喉镜组 | 平卧位光棒组 | 侧卧位光棒组 | 平卧位喉镜组 | 平卧位光棒组 | 侧卧位光棒组 |
| 诱导前 | 94.1±9.5 | 90.0±10.1 | 91.2±9.8 | 74±13 | 75±12 | 76±15 |
| 诱导后 | 85.2±8.2 | 79.3±8.5 | 80.2±8.7 | 71±14 | 70±11 | 72±13 |
| 插管后 1 min | 96.3±10.5 ^a | 93.5±10.3 ^a | 92.3±10.2 ^a | 77±15 ^a | 78±13 ^a | 78±16 ^a |
| 插管后 3 min | 95.8±10.1 | 92.6±9.6 | 91.2±10.7 | 75±15 | 76±12 | 77±17 |
| 插管后 5 min | 94.9±9.7 | 91.3±9.5 | 90.6±8.9 | 75±13 | 75±14 | 76±15 |

^a*P*<0.05 vs 诱导后.